

CATÁLOGO
DE PRODUTOS
Esterilização (CME)

**Suprindo hoje,
pensando no
amanhã!**

ÍNDICE

ESTERILIZAÇÃO A VAPOR	4
ESTERILIZAÇÃO BAIXA TEMPERATURA	6
LIMPEZA NO PONTO DE USO	8
DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL	10
LIMPEZA NO CME	12
MONITORAMENTO DA LIMPEZA	15
SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO BAIXA TEMP.	17

CATÁLOGO
DE PRODUTOS
Esterilização (CME)



Monitoramento
para
Esterilização a
Vapor

MONITORAMENTO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR




Verify™ All-In-One



Pacote Teste Bowie-Dich Verify™



Pacote Desafio Verify™ Assert

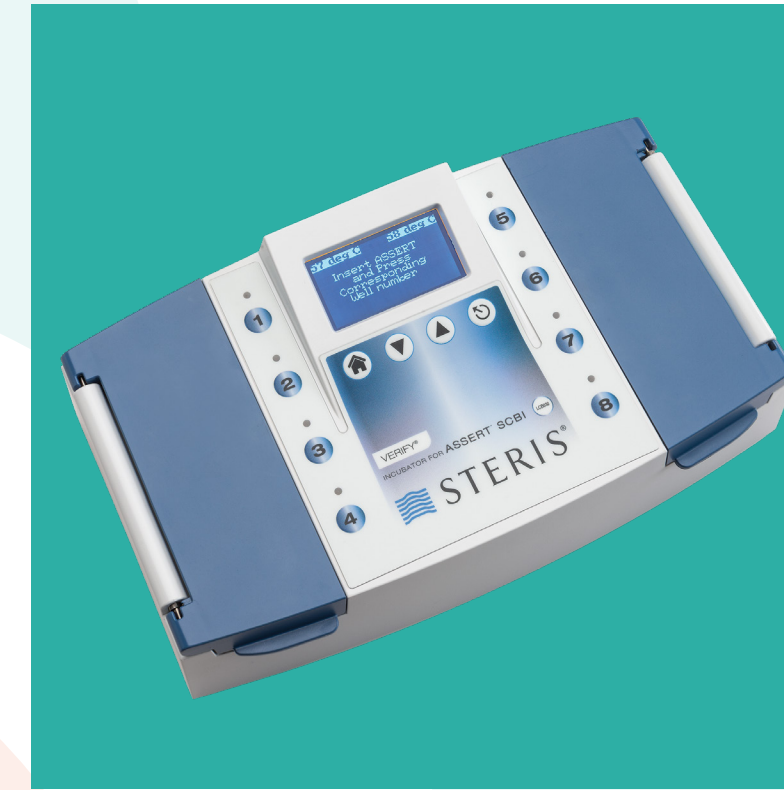

Incubadora Verify®



Indicador de Integração Verify™



Indicador Biológico Verify™ Assert (SCBI)



Indicador Biológico Celerity 20 STEAM



Etiquetadora 3 Linhas de Impressão



Incubadora Celerity™ 20 STEAM



Monitoramento
para Esterilização
a Baixa
Temperatura

MONITORAMENTO PARA ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA



**Celerity™ HP
Indicator Tape**
PCC077



**Celerity™ 5 HP
Indicador Biológico**
LCB052



**Indicador Químico
Multivariável
Celerity™ HP**
PCC079



**Etiqueta c/ Indicador Químico
e Dados p/ Rastreabilidade
Celerity™ HP**
PCC078



**Indicador Biológico
Celerity™ 20 HP**
LCB044



**Fita Indicadora
Verify™**
VH202



**Vaprox HC
Esterilizante**



**Incubadora
Celerity™**
LCB060



**Incubadora
Celerity™ 20 HP**
PCC078




Limpeza
no Ponto de Uso

LIMPEZA NO PONTO DE USO



**Pre-Klenz™
Umectante em Gel**

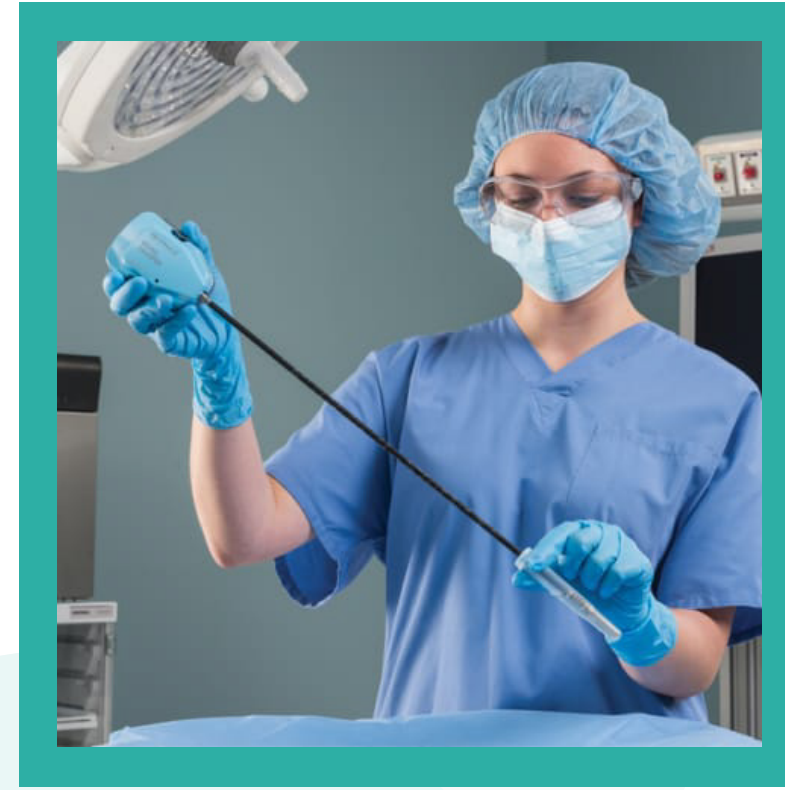

**Pre-Klenz™ Soak
Shield**



Desinfecção de
Alto Nível

DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL



Esponja Revital-Ox D



Escova Revital-Ox



Revital-Ox Resert R60



Revital-Ox Detergente Enzimático



Revital-Ox Contêiner Flexível



Limpeza
no CME

LIMPEZA NO CME



Isaspor Solução Esterelizante a Frio e Desinfetante



Proteazone Plus Detergente e Limpador



Steroptimal Removedor



Detergente Enzimático Prolystica® Ultraconcentrado 5L e 10L
1C03T4WR e 1C03T6WR



Detergente Neutro Prolystica® Ultraconcentrado 5L e 10L
1C07T4WR e 1C07T6WR



Detergente Alcalino Prolystica® Ultraconcentrado 5L e 10L
1C12T4WR e 1C12T6WR



Detergente Lubrificante Prolystica® Ultraconcentrado 5L e 10L
1C05T4WR e 1C05T6WR

LIMPEZA NO CME



Detergente Enzimático Prolystica® Ultraconcentrado HP 5L e 10L
1C16T4 e 1C16T6



Detergente Neutro Prolystica® Ultraconcentrado HP 5L e 10L
1C15T4 e 1C15T6



Detergente Alcalino Prolystica® Ultraconcentrado HP 5L e 10L
1C17T4 e 1C17T6



Desincrustante Prolystica® Restore 1C45AW



Lubrificante Hinge-Free®
103108




Liqui-Jet® 2 Detergente p/ Instrumental



Monitoramento
da Limpeza


MONITORAMENTO DA LIMPEZA

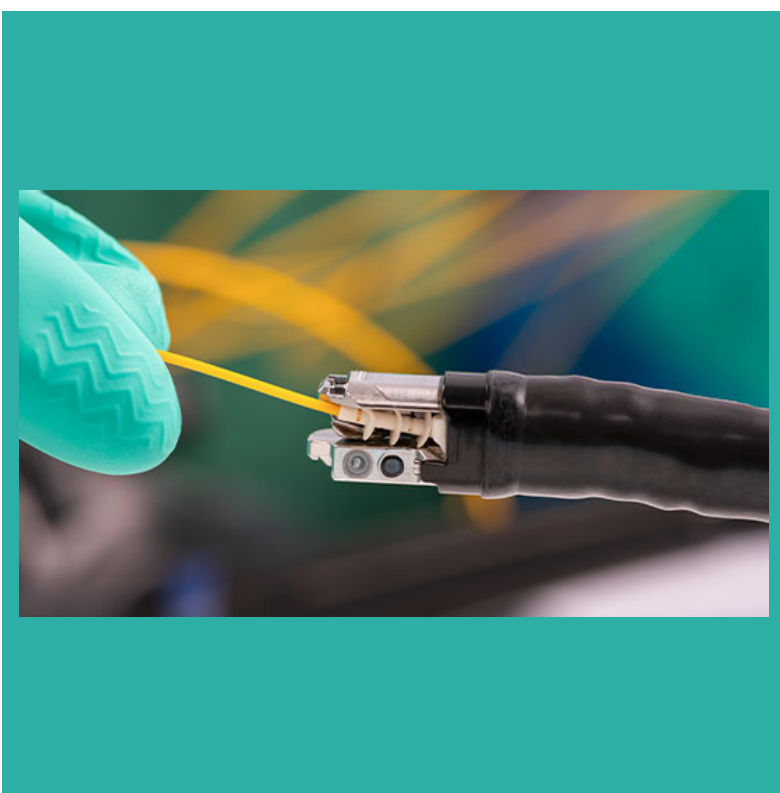


**Verify™ Resi-Test™
Slide-Thru**



**Verify™ Indicador
Ultrassônico**

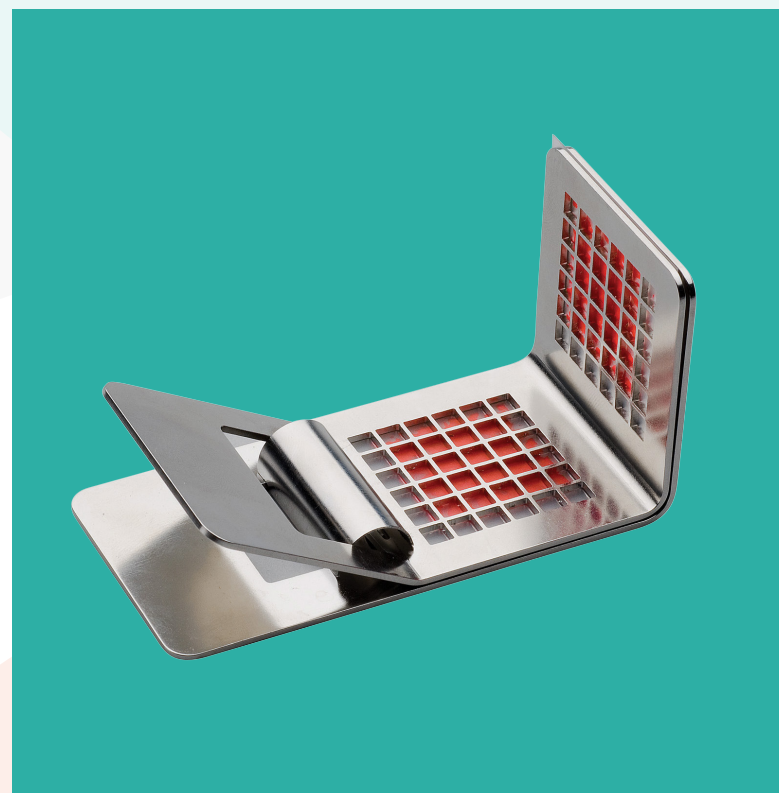

Verify™ All Clean

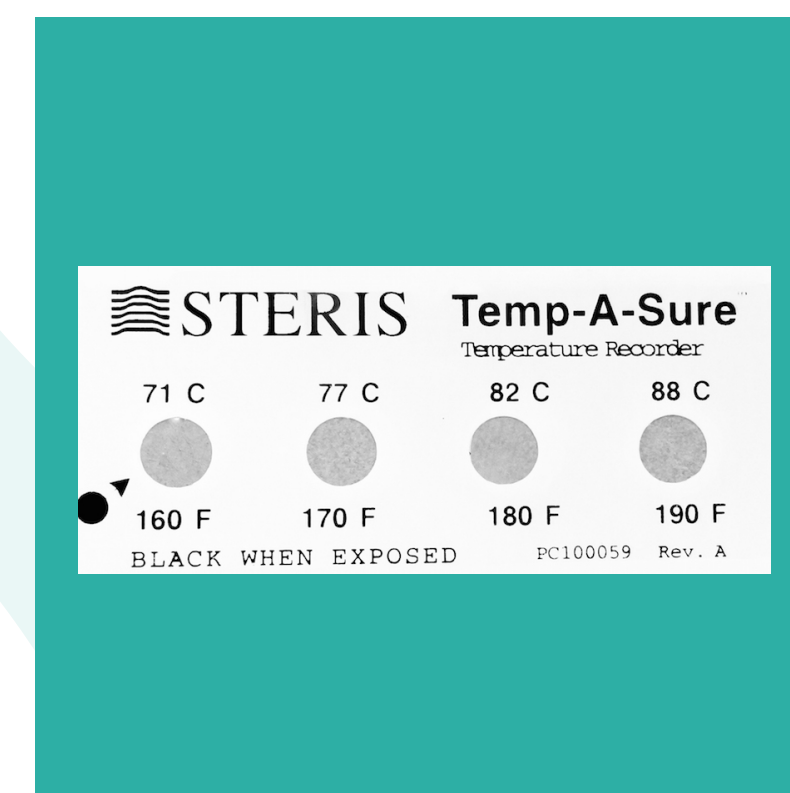

**Temp-A-Sure™
Indicadores de
Temperatura**



**Resi-Test™ Kit de
Detecção de
Proteínas**



Sistema de
esterilização a
baixa
temperatura

SISTEMA DE ESTERILIZAÇÃO A BAIXA TEMPERATURA



V-PRO™ maX 2



V-PRO™ s2


Peça agora!

 **(21) 98481-5695**
Atendimento RJ

 **comercial@medsut.com.br**

 **(21) 99886-7268**
Atendimento ES

 **atendimento.es@medsut.com.br**

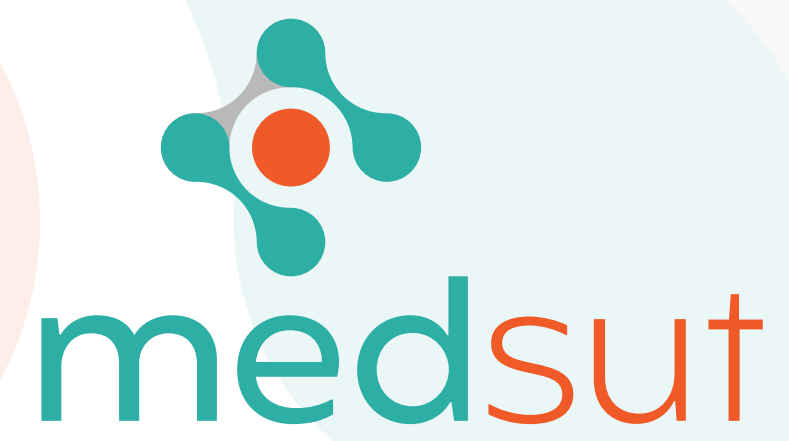

[medsut.com.br](https://www.medsut.com.br)